




新浄化システム参考例

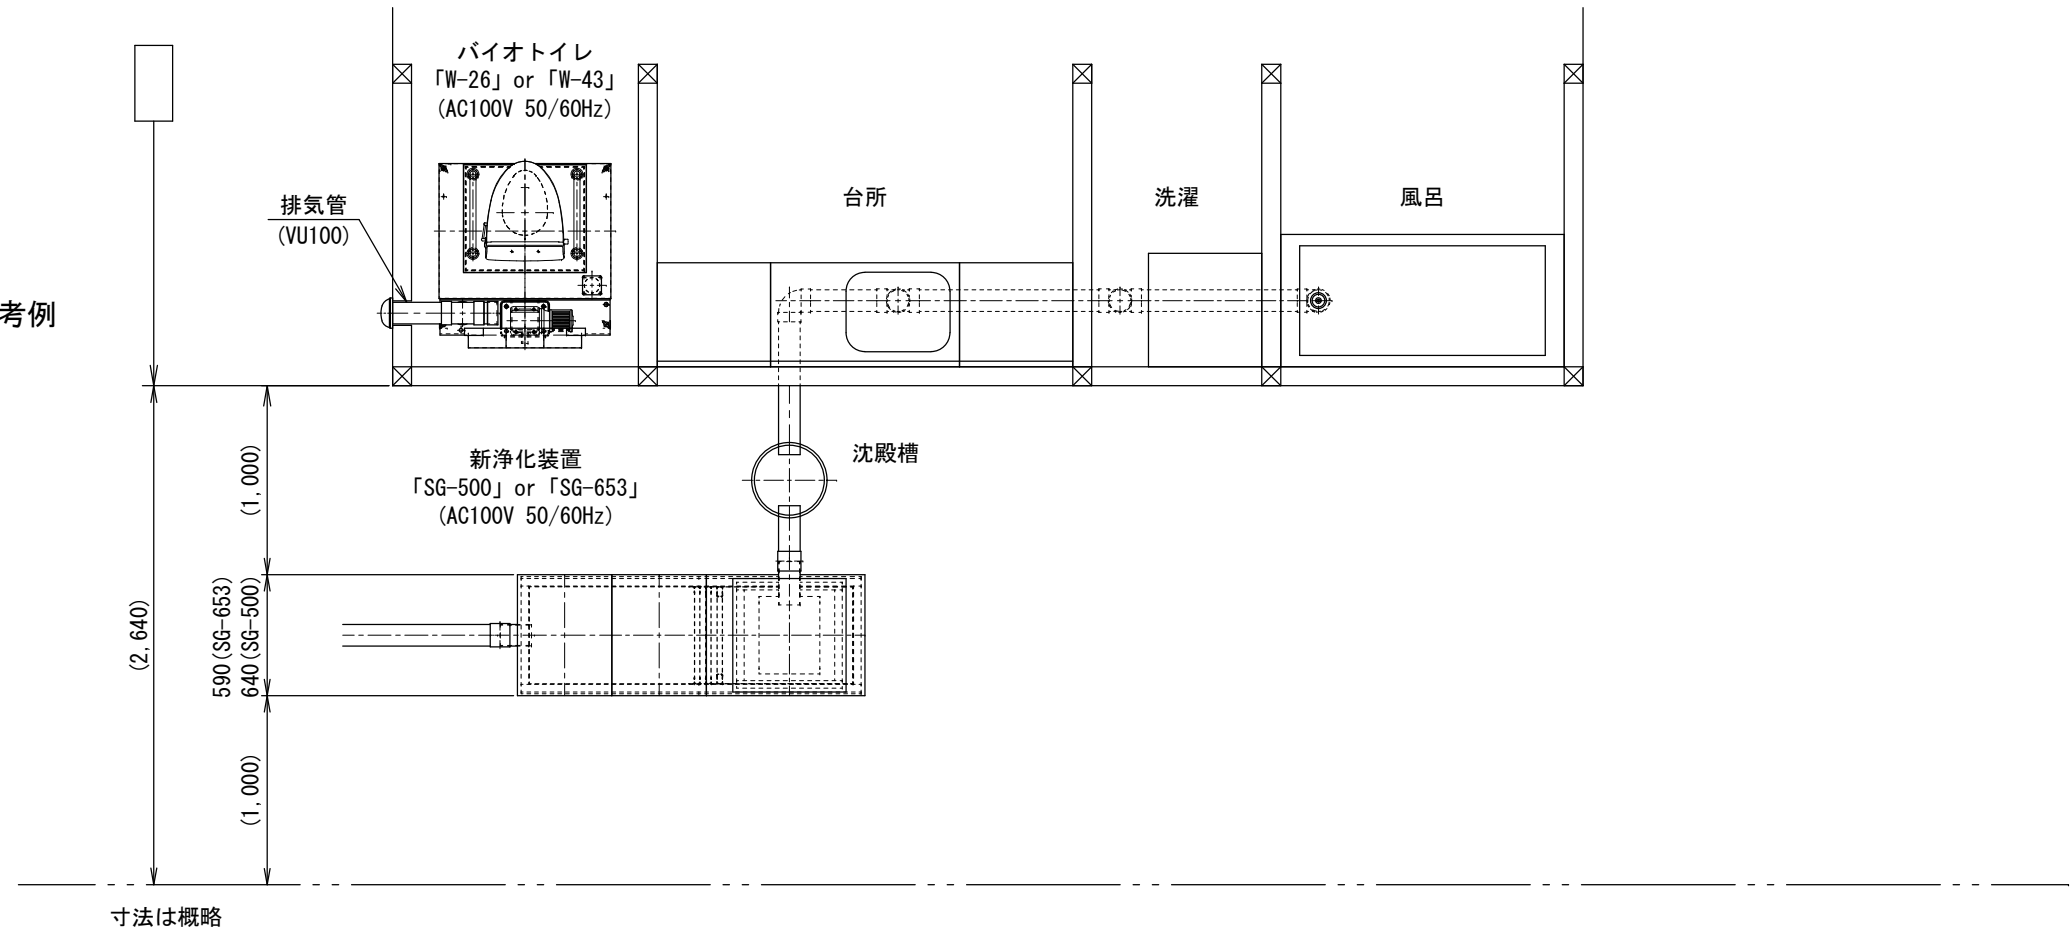


※. バイオトイレのおガクズ交換は1年に2~3回です。
(排気管と中間ファンの点検も同様)

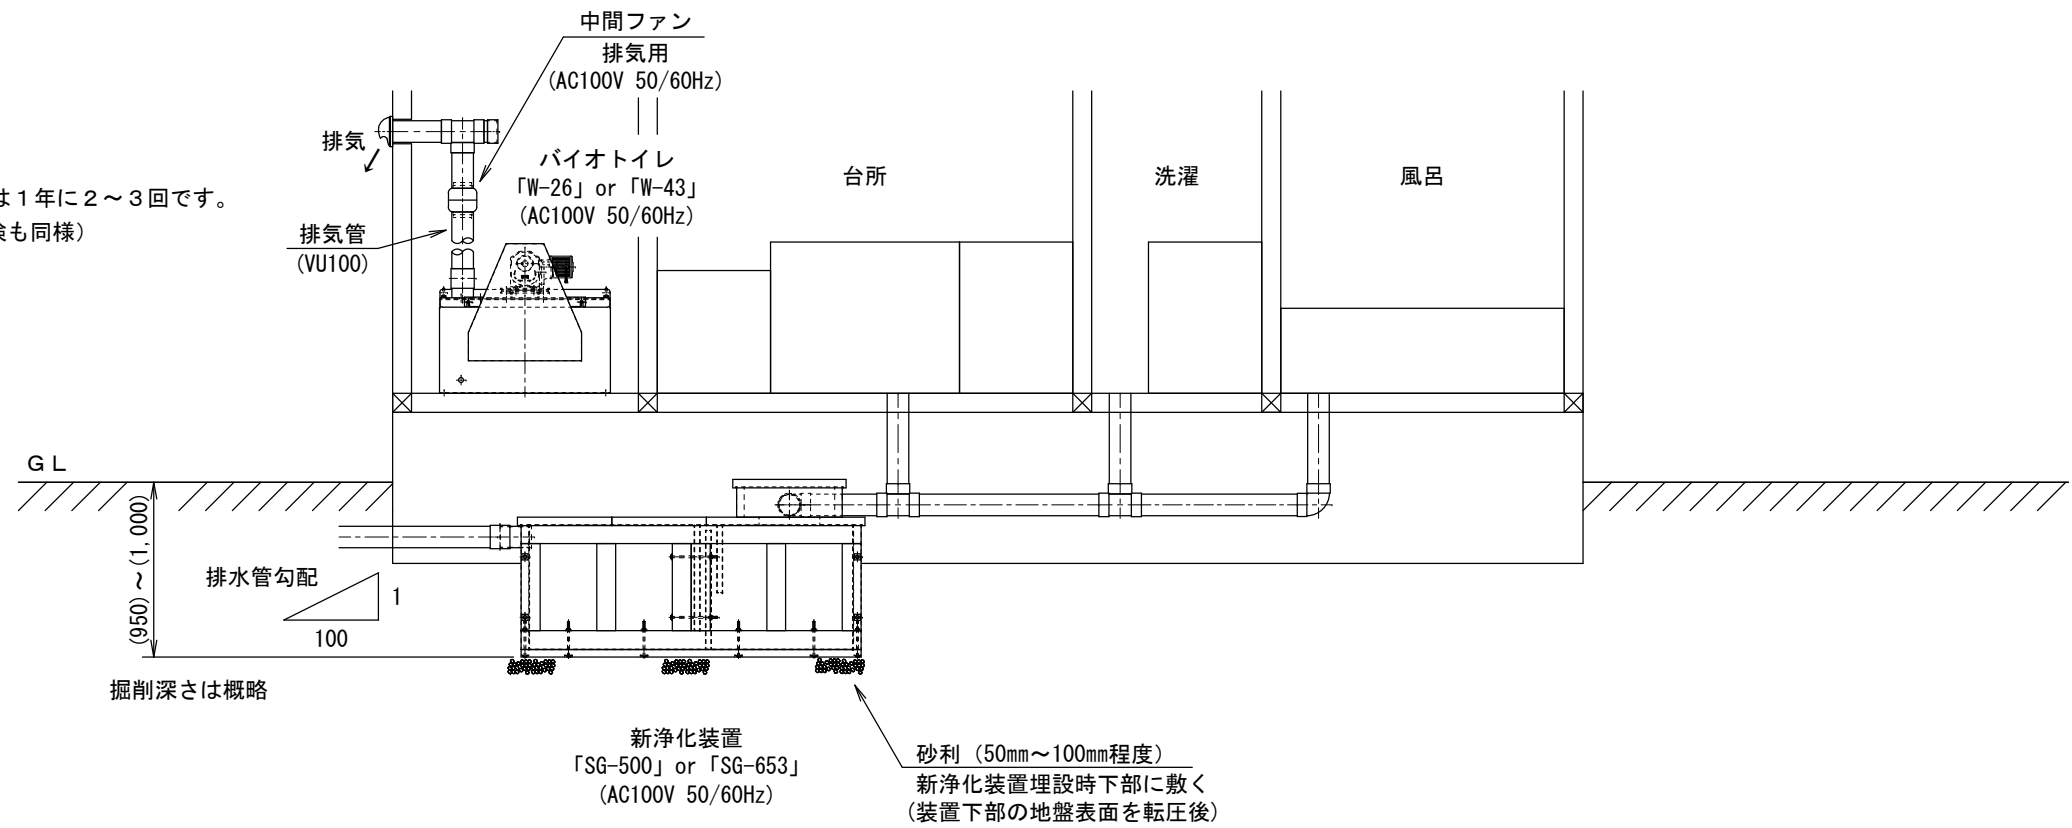

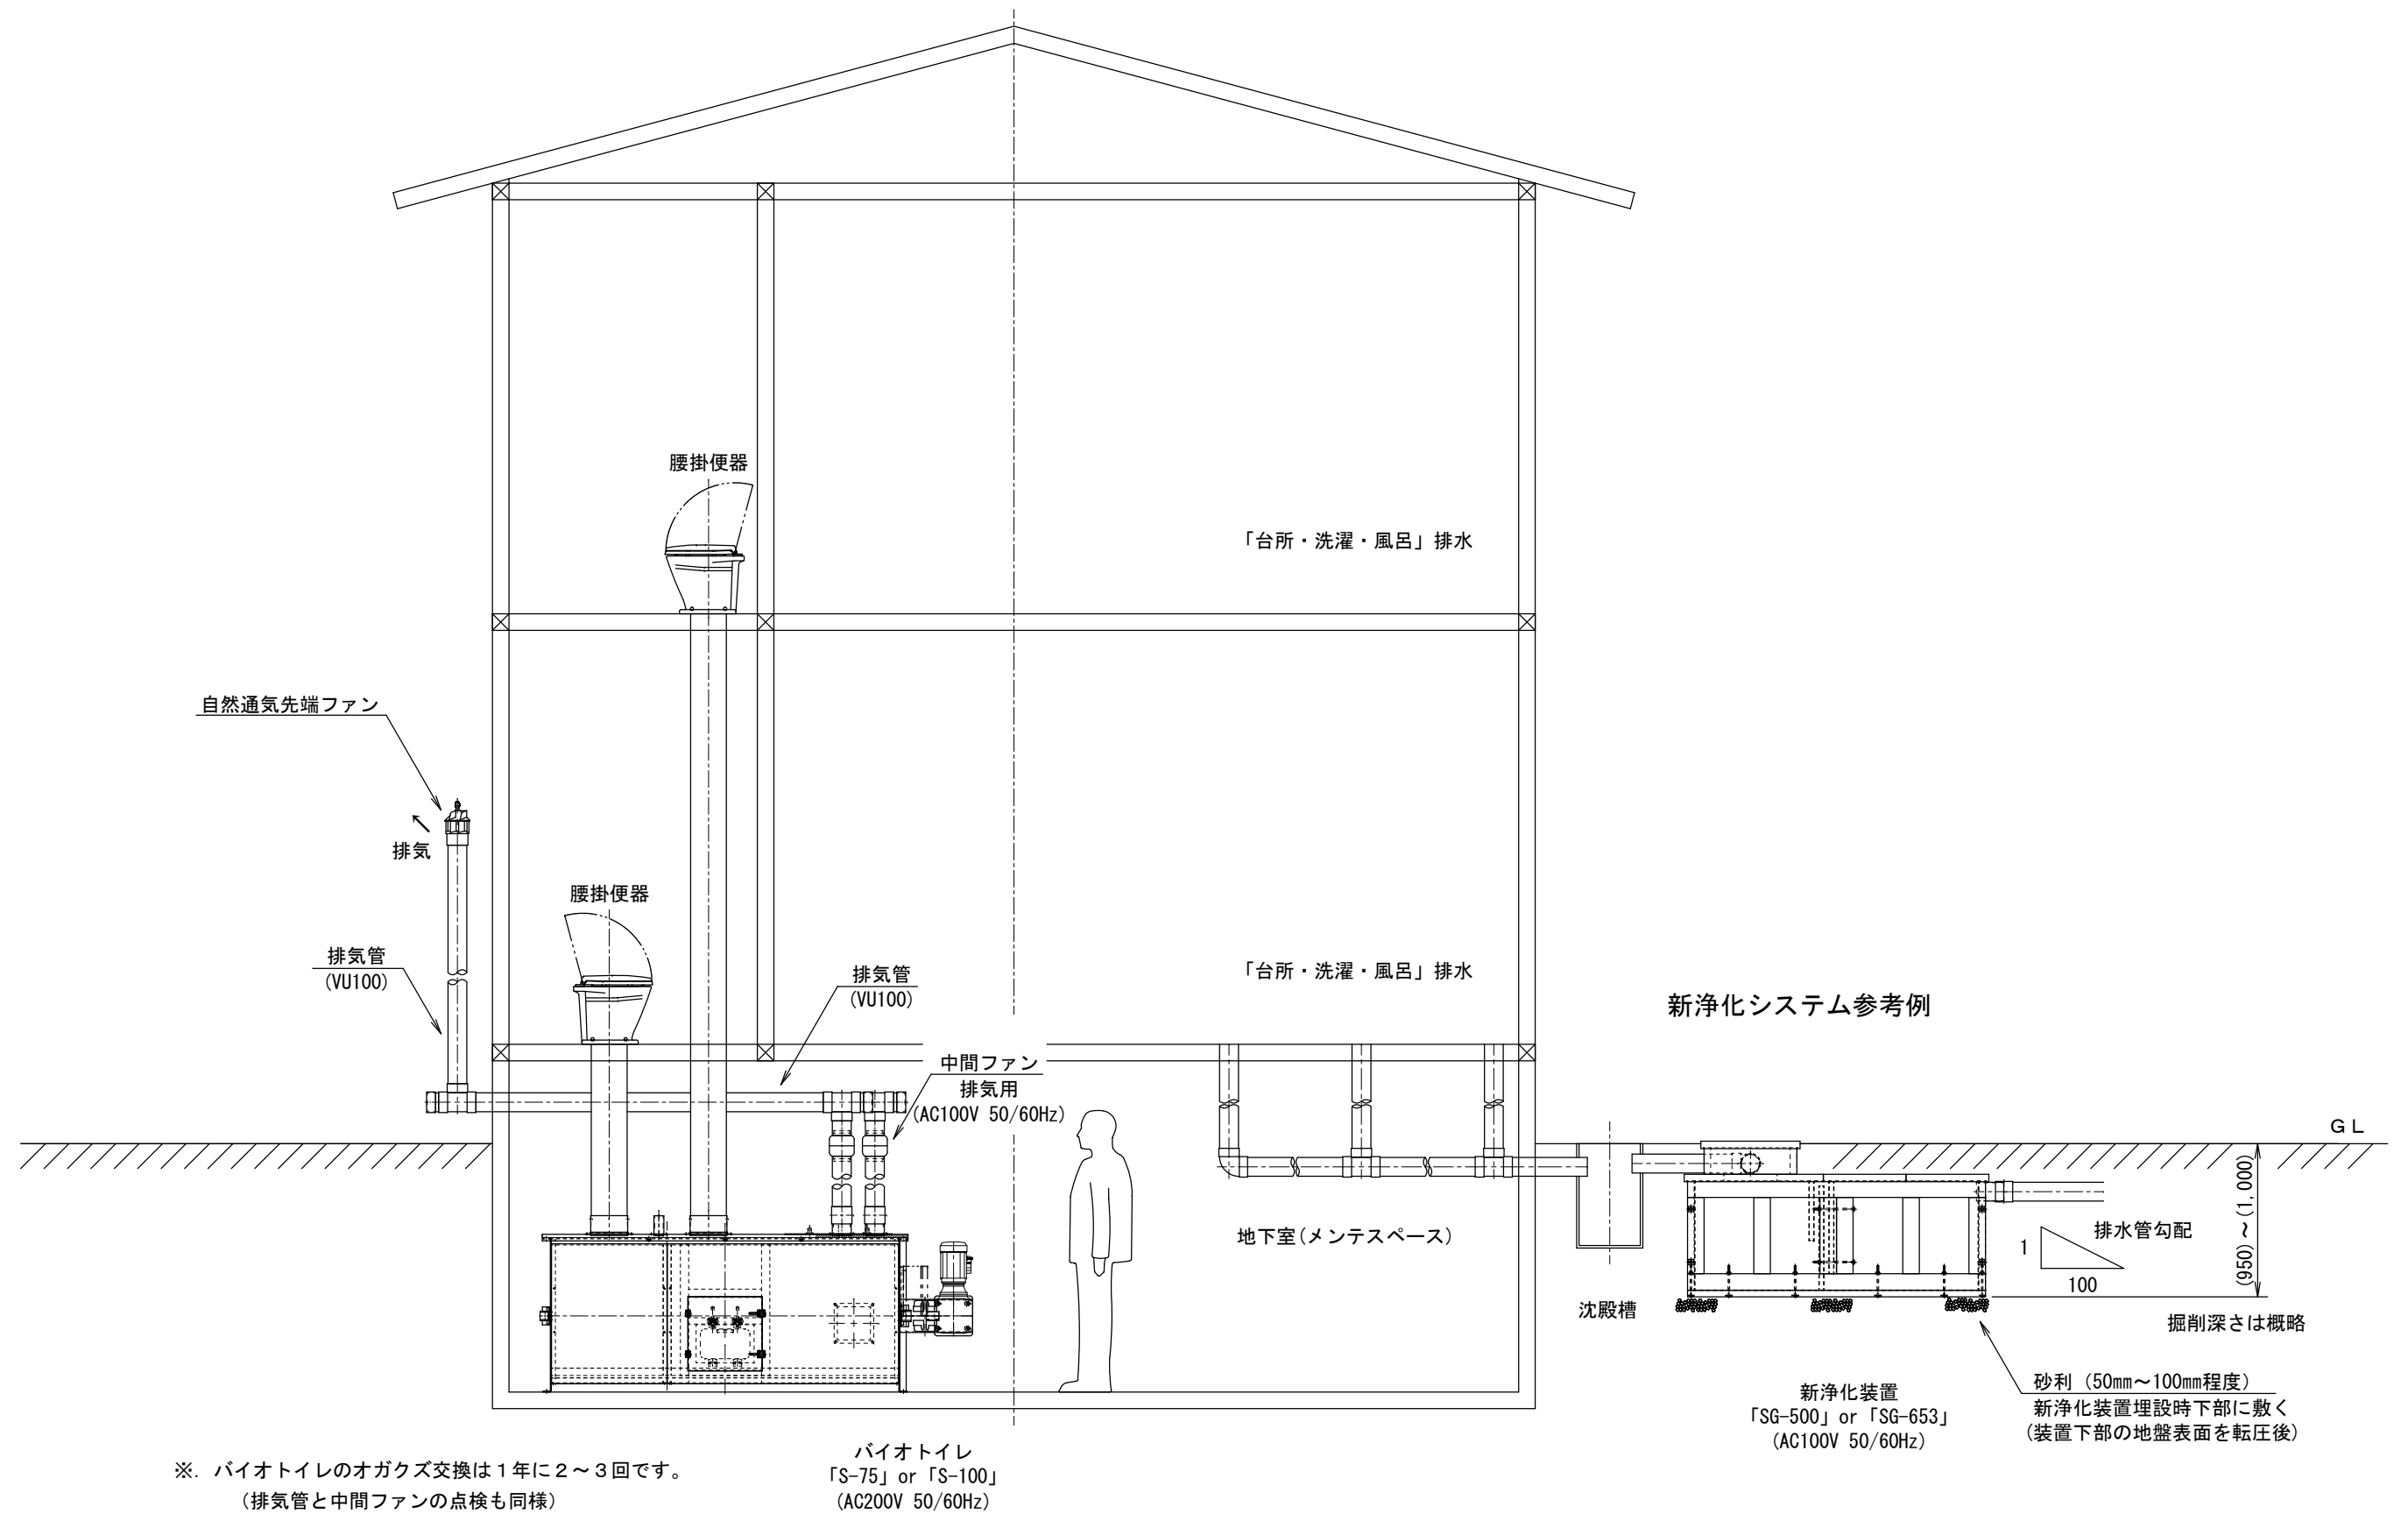

配置イメージ図「2」

2016, 09, 15

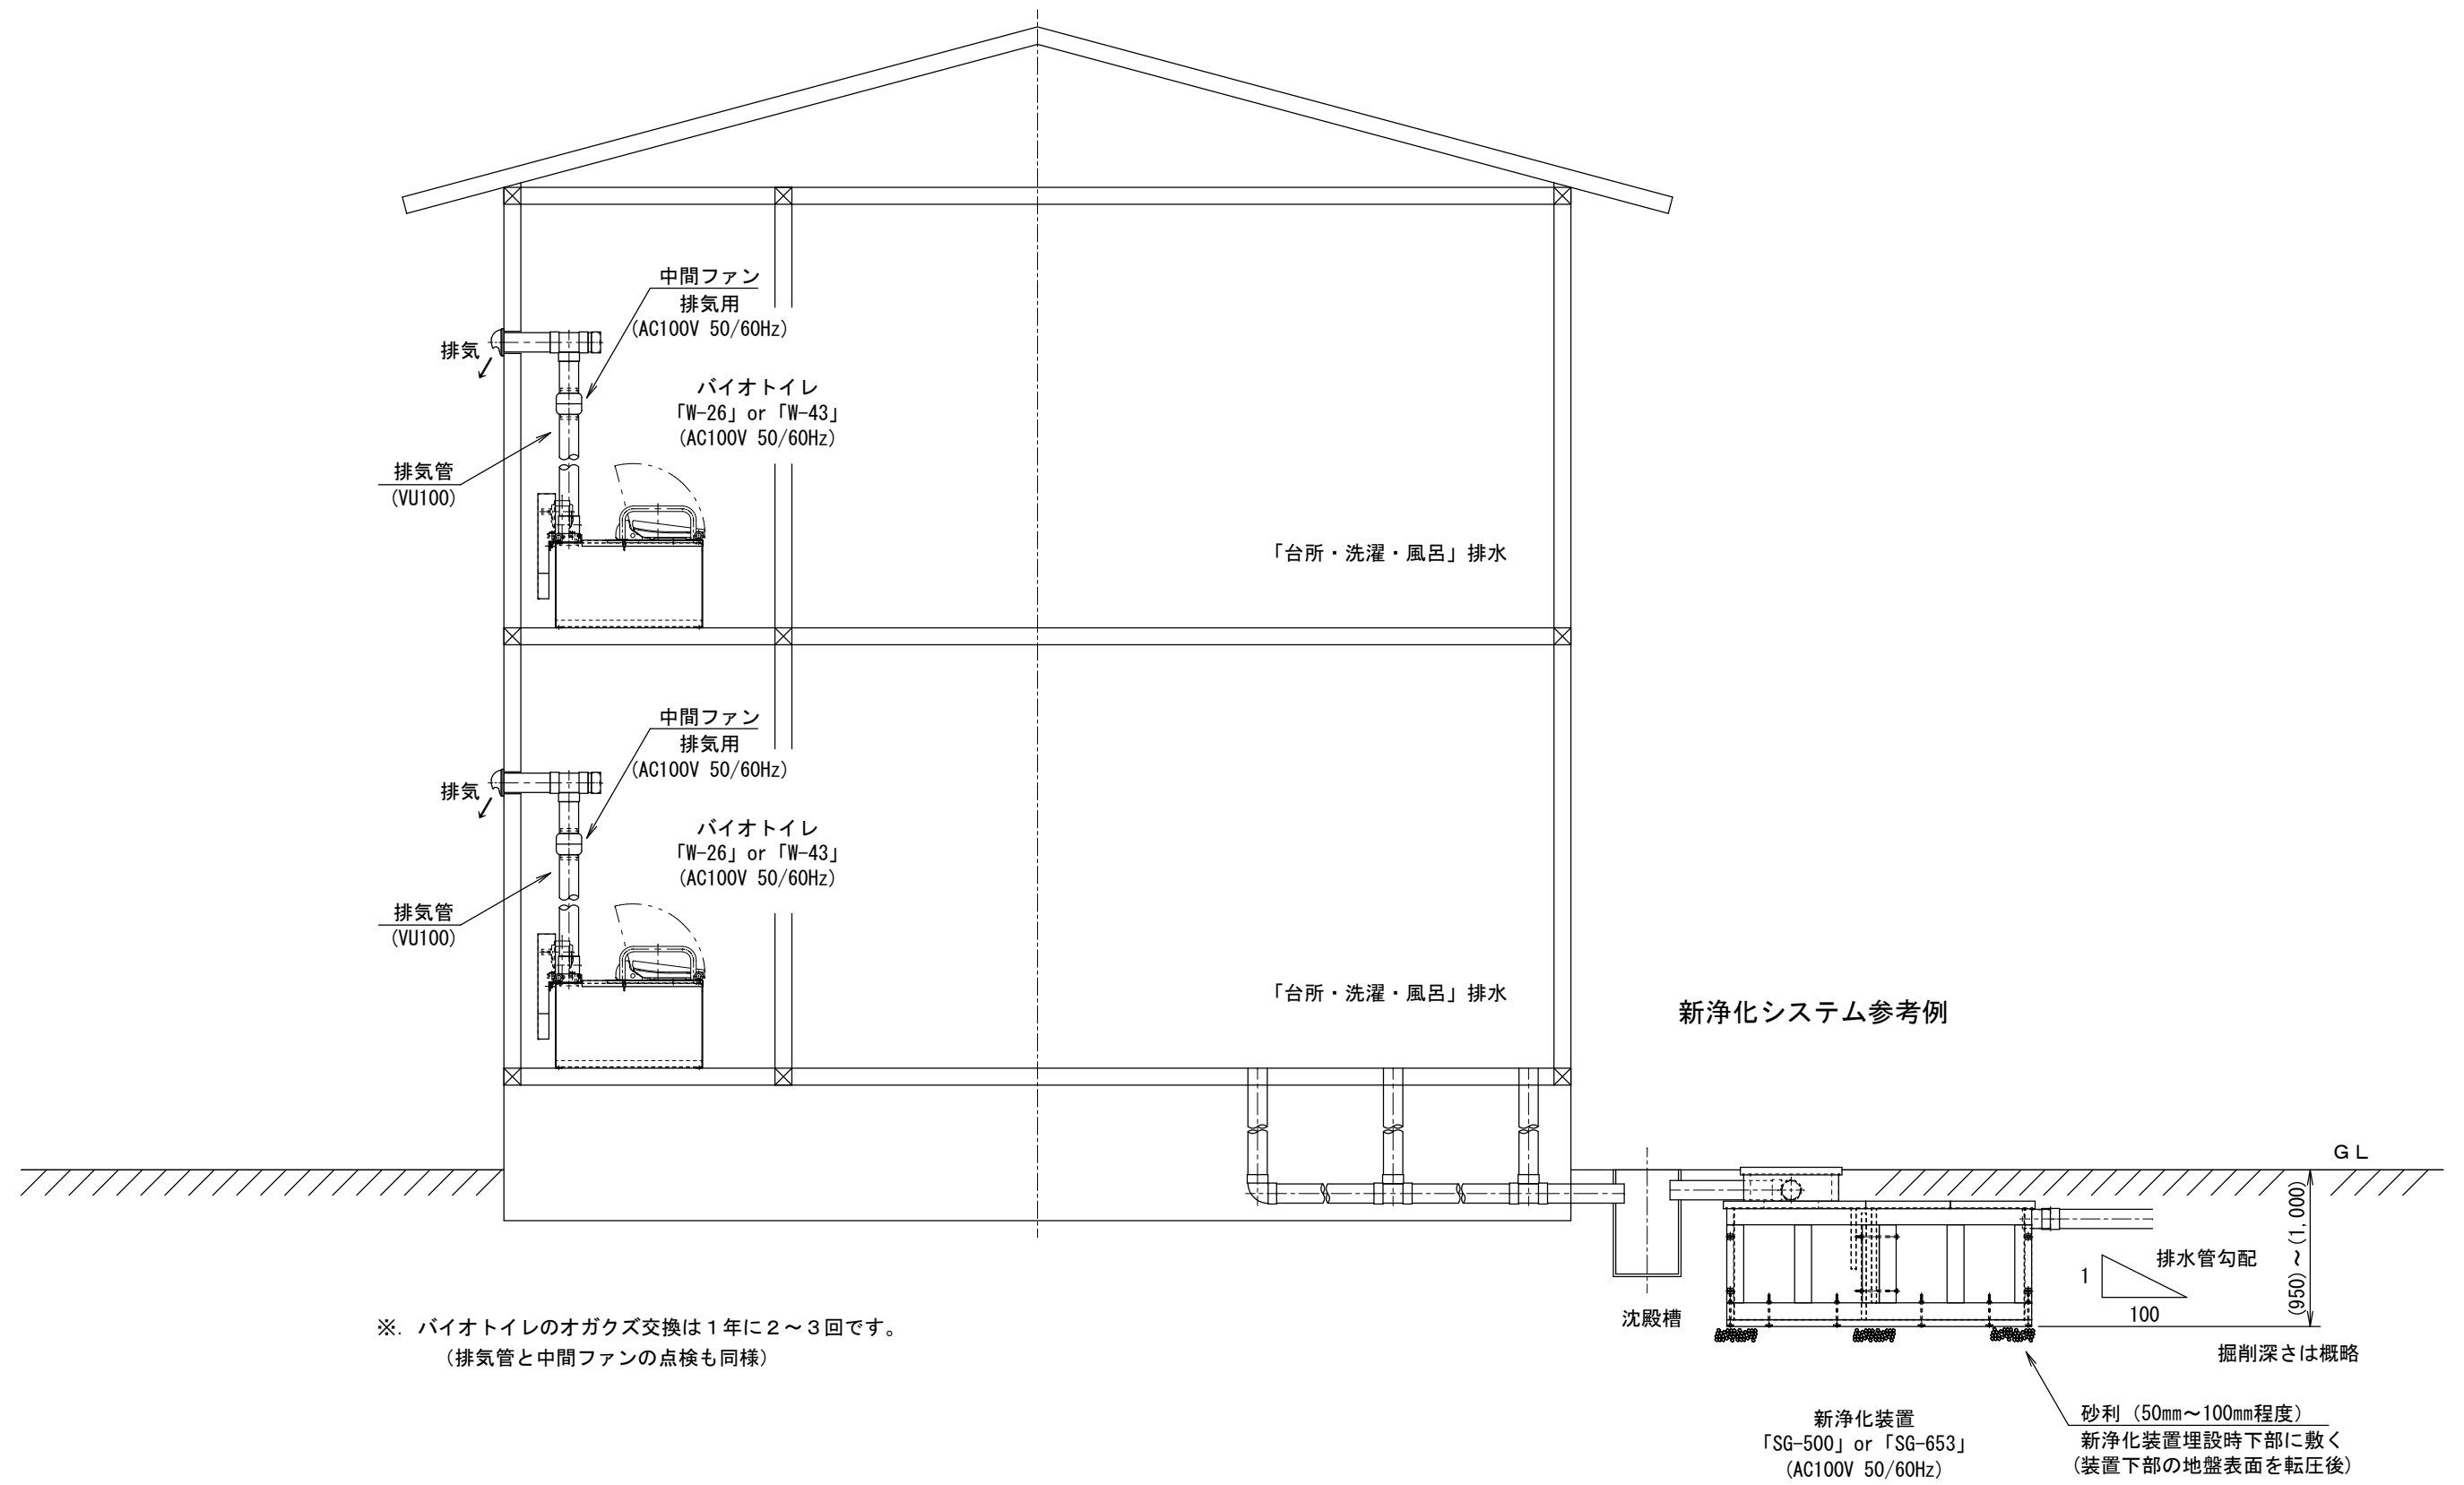

※. バイオトイレのオガクズ交換は1年に2~3回です。
(排気管と中間ファンの点検も同様)